

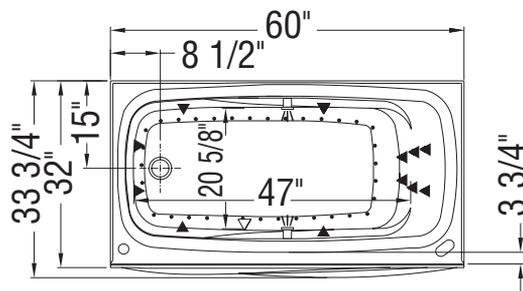


SYSTÈMES HYDROSENS, BACKMAX ET À AIR

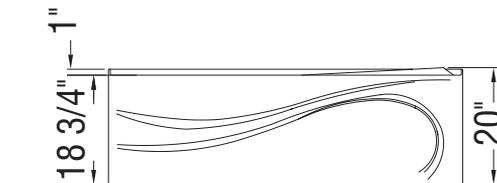

SYSTÈME MICRO-JETS

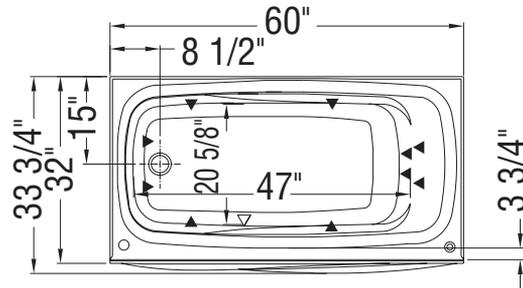

- (▲): Indique la position des jets tourbillon et dorsaux
- (△): Indique la position de la succion
- (●): Indique la position des jets d'air
- (♨): Indique la position de la chromothérapie

Toutes ces dimensions sont approximatives. Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.